

Description of this Thermometer

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor / measuring tip
- ⑤ Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception! Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- For safety reasons (risk of rectal perforation) rectal measurement in children younger than 3 years must be performed only by trained health care personnel (professional user). Use another measurement method instead. For rectal fever measurement in small children younger than 3 years, thermometers with a flexible tip are available.
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button (1); a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field (2). The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer can now be read. To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button (1). Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button (1) is pressed for more than 2 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor (4) under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading.

Microlife UAB, P. Lukšio g. 32
08222 Vilnius, Lithuania

Microlife Corporation
9F, 431 RuiGuang Road, NeiHu
Taipei 114, Taiwan, China

CE 0044

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Préférez la réparation au don de votre appareil !



Beschreibung des Thermometers

DE
Der Mess-Sensor (4) des Thermometers wird vorsichtig 2-3 cm weit in den After eingeführt.
Die Verwendung von Schutzhüllen und eines Gleitmittels wird empfohlen.

Wenn Sie sich bei dieser Messmethode nicht sicher sind, sollten Sie einen Fachmann zur Anleitung / Schulung konsultieren.

Mindestmesszeit: 1 Minute!

Reinigung und Desinfektion

Verwenden Sie zur Desinfektion im Heimgebrauch einen Isopropylalkoholputfer (70%) oder ein mit 70% Isopropylalkohol angefeuchtetes Baumwolttuch, um Oberflächenverschmutzung von der Thermometer Messsonde abzuwaschen (Hinweis): Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Desinfektionsmittelherstellers.

Beginnen Sie immer mit dem Abwaschen vom Ende der Thermometer Messsonde (ca. in der Mitte des Thermometers) in Richtung der Thermometer Messspitze. Anschließend sollte das gesamte Thermometer (siehe Nummer (5) in der Abbildung) mindestens 5 Minuten (max. 24 Stunden) in 70% Isopropylalkohol getaut werden. Lassen Sie das Desinfektionsmittel vor dem nächsten Gebrauch 1 Minute lang trocknen.

Für den professionellen Gebrauch: Zusätzlich können Sie Schutzhüllen anbringen (als Zubehör erhältlich). Wenden Sie sich an Microlife, um mehr Informationen zu weiteren Desinfektionsmitteln für Ihr Thermometermodell zu erhalten.

Batteriewechsel

Sobald im Display das Symbol «▼» (umgedrehtes Dreieck) erscheint, ist die Batterie erschöpft und ein Batteriewechsel ist fällig. Die Abdeckung des Batteriefachs (3) abziehen, um die Thermometerbatterie auszutauschen. Eine neue Batterie mit dem Zeichen + nach oben in das Batteriefach einlegen. Achten Sie darauf, dass der gleiche Batterietyp verwendet wird. Batterien erhalten Sie in jedem Elektrofachgeschäft.

Technische Daten

Typ: Maximum-Thermometer
Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C
Temp. < 32,0 °C: Display «L» für low (zu tief)
Temp. > 43,9 °C: Display «H» für high (zu hoch)

Messgenauigkeit: ± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C und 42,1 - 43,9 °C

Betriebsbedingungen: 10 - 40 °C; 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit
-25 - +60 °C; 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit

Aufbewahrungsbedingungen: Batterie: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Batterie-Lebensdauer: ca. 4500 Messungen (mit neuer Batterie)
IP67

IP Klasse: EN 12470-3, klinische Thermometer; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Durchschnittliche Lebensdauer: 5 Jahre oder 10000 Messungen

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie für Medizinische Geräte 93/42/EWG.

Technische Änderungen vorbehalten.

Registrazione dei valori misurati

Se si tiene premuto il pulsante ON/OFF (1) per più di 2 secondi quando si accende il termostero comparirà automaticamente sul display la temperatura registrata durante l'ultima misurazione e una piccola «M» indicherà che la lettura è di un dato in memoria. Circa 2 secondi dopo aver rilasciato il pulsante il valore della temperatura scompare ed il termostero è pronto per la misurazione.

Tipo di misurazione / Temperatura corporea normale

► Asciellare / 34.7 - 37.3 °C Asciugare l'ascella utilizzando un asciugamano asciutto. Posizionare il sensore di misurazione (4) sotto il braccio, al centro dell'ascella, in modo che sia contatto con la pelle e tenere il braccio vicino al corpo. In questo modo la temperatura ambiente non influirà sulla misurazione. La misurazione asciellare richiede più tempo per raggiungere una temperatura stabile; si raccomanda quindi di mantenere il termostero sotto l'ascella per almeno 5 minuti dopo il segnale acustico.

Orale / 35.5 - 37.5 °C Non mangiare o bere qualcosa di caldo o freddo 10 minuti prima della misurazione. La bocca dovrà rimanere chiusa per 2 minuti prima di iniziare la misurazione.

Introdurre il termostero in una delle due sacche, a sinistra o a destra, accanto alla radice della lingua. Il sensore del termostero (4) deve essere bene in contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e respirare solo dal naso per non alterare la misurazione.

Se non fosse possibile, a causa delle vie aeree costipate, utilizzare un altro metodo di misurazione.

Tempo di misurazione approssimativo: 1 minuto!

► Rettale / 36.6 - 38.0 °C Attenzione: per prevenire la perforazione rettale nei bambini (sotto i 3 anni di età), si consiglia di utilizzare un altro metodo di misurazione o un termometro con sonda flessibile.

Introdurre con precauzione il sensore del termostero (4) nell'ano sino a un massimo di 2-3 cm. Si raccomanda l'uso di copri sonda e di un lubrificante.

Se non si conosce questo metodo di misurazione, prima dell'utilizzo si consiglia di consultare un operatore sanitario per assistenza/aiuto.

Tempo di misurazione approssimativo: 1 minuto!

► Bimbo / 34.0 - 37.0 °C Attenzione: per prevenire la perforazione rettale nei bambini (sotto i 3 anni di età), si consiglia di utilizzare un altro metodo di misurazione o un termometro con sonda flessibile.

Introdurre con precauzione il sensore del termostero (4) nell'ano sino a un massimo di 2-3 cm. Si raccomanda l'uso di copri sonda e di un lubrificante.

Se non si conosce questo metodo di misurazione, prima dell'utilizzo si consiglia di consultare un operatore sanitario per assistenza/aiuto.

Tempo di misurazione approssimativo: 1 minuto!

► Anus / 36.6 - 38.0 °C Attenzione: per prevenire la perforazione rettale nei bambini (sotto i 3 anni di età), si consiglia di utilizzare un altro metodo di misurazione o un termometro con sonda flessibile.

Introdurre con precauzione il sensore del termostero (4) nell'ano sino a un massimo di 2-3 cm. Si raccomanda l'uso di copri sonda e di un lubrificante.

Se non si conosce questo metodo di misurazione, prima dell'utilizzo si consiglia di consultare un operatore sanitario per assistenza/aiuto.

Tempo di misurazione approssimativo: 1 minuto!

► Pulizia e disinfezione

Per disinfezare il dispositivo a casa, utilizzare un tamponcino imbevuto di alcool isopropilico al 70% o un panno di cotone inumidito con alcool isopropilico al 70% per pulire la sonda del termostero da agenti inquinanti superficiali. Iniziare la pulizia partendo sempre dalla sonda (circa al centro del termostero) verso la punta del termostero. Successivamente tutto il termostero (vedere il numero (5) nell'immagine) dovrà essere immerso in alcool isopropilico al 70% per almeno 5 minuti (massimo 24 ore). Dopo l'immersione, lasciare asciugare il dispositivo per 1 minuto prima di utilizzarlo nuovamente.

Per uso professionale: E' possibile, inoltre, applicare i copri-sonda (disponibili come accessorio). Contatta Microlife per maggiori informazioni su altri disinfectanti per il tuo modello di termostero.

Importanti misure preventivali

• Seguire le istruzioni d'uso. Questo manuale contiene informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza di questo dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il dispositivo e di conservarle per ogni futura consultazione.

• Questo dispositivo deve essere utilizzato solo per misurare la temperatura corporea per via orale, rettale o asciellare. Non cercare di misurare la temperatura in altre aree del corpo, come l'orecchio, in quanto potrebbe causare false letture e lesioni.

• Non utilizzare questo dispositivo se si ritiene che sia danneggiato o si notano anomalie.

• Per motivi di igiene, prima del primo utilizzo, si raccomanda di pulire questo dispositivo seguendo le istruzioni di pulizia.

• Il tempo di misurazione minimo, fino al beep, deve essere sempre rispettato senza eccezioni!

Occorre tenere in considerazione che aree di misurazione diverse potrebbero richiedere di continuare la misurazione anche dopo il segnale acustico, vedere la sezione «Tipi di misurazione / Temperatura corporea normale».

• Per motivi di sicurezza (rischio di perforazione rettale) la misurazione rettale nei bambini di età inferiore ai 3 anni deve essere eseguita solo da personale sanitario (utente professionale). Si consiglia di utilizzare un altro metodo di misurazione. Per la misurazione della temperatura rettale nei bambini di età inferiore ai 3 anni, sono disponibili termostomi con punta flessibile, e.

• Non effettuare misurazioni rettali su persone con distorsioni/bretti.

• Ciò potrebbe aggravare o peggiorare il disturbo.

• Assicurarsi che i bambini non utilizzi il dispositivo senza la supervisione di un adulto. Alcune parti sono piccole e potrebbero

essere ingerite. Prestare attenzione al rischio di strangolamento in presenza di cavi o tubi.

• Non usare il dispositivo vicino a forti campi elettromagnetici come telefoni cellulari o installazioni radio. Mantenere una distanza minima di 3 m da altri apparecchi quando si utilizza questo dispositivo.

• Proteggere lo strumento da urti e cadute!

• Evitare temperature ambientali superiori ai 60°C: NON IMMERGERE lo strumento in acqua bolente!

• Per evitare danni al dispositivo durante la pulizia, utilizzare solo i disinfettanti in commercio elencati nella sezione «Pulizia e disinfezione».

• Si consiglia di fare verificare la precisione di questo dispositivo ogni due anni o dopo che ha subito un impatto (ad es. caduta). Si prega di contattare il servizio di assistenza Microlife per programmare il test.

ATTENZIONE: la misurazione ottenuta con questo dispositivo non rappresenta una diagnosi! Non fare affidamento solo sulla misurazione.

Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni locali e non con i rifiuti domestici.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo dispositivo.

Parte applicata tipo BF

Aspettativa di vita del prodotto in uso:

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Garanzia

Questo dispositivo è coperto da una garanzia a vita dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, Microlife, a sua discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente il prodotto difettoso.

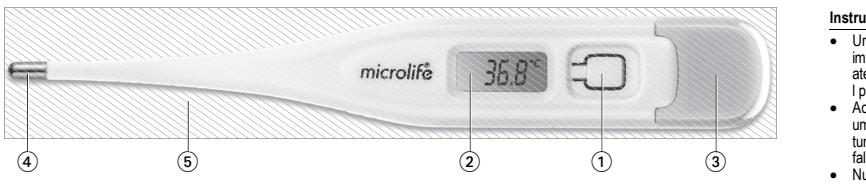
L'apertura o la manomissione del dispositivo invalida la garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:

- costi e rischi di trasporto.

- danni causati da uso scorretto o dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso.

- danni causati da perdite delle batterie.

**Descripción de este termómetro**

- (1) Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
(2) Pantalla
(3) Tapa del compartimento de la batería
(4) Sensor de medición / punta de medición
(5) Área de limpieza y desinfección (superficie completa del termómetro)

Instrucciones importantes de seguridad

- Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.
- Este dispositivo solo se debe utilizar para medir la temperatura del cuerpo humano por vía oral, rectal o axilar. No intente tomar temperaturas en otros sitios, como en el oído, ya que puede dar lugar a lecturas falsas y provocar lesiones.
- No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna anomalía.
- Recomendamos limpiar este dispositivo de acuerdo con las instrucciones de limpieza antes del primer uso para la higiene personal.
- Si se debe respetar, sin excepción, el tiempo mínimo de medición, hasta escuchar un pitido o señal de bip!
- Tenga en cuenta que las diferentes ubicaciones de medición pueden requerir una medición continua incluso después del pitido, consulte la sección "Tipos de medición / Temperatura corporal normal".
- Por razones de seguridad (riesgo de perforación rectal), la medición rectal en niños menores de 3 años debe ser realizada solo por personal de salud capacitado (usuario profesional). Use otro método de medición en su lugar. Para la medición de la fiebre rectal en niños pequeños menores de 3 años, se encuentran disponibles termómetros con punta flexible.
- No intente realizar mediciones rectales en personas con trastornos rectales. Hacerlo puede agravar o empeorar el trastorno.
- Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían tragarse algunas de las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se suministre con cables o tubos.
- No use el dispositivo cerca de fuertes campos eléctricos tales como teléfonos móviles o equipos de radio. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 3,3 m de estos aparatos cuando utilice.
- Proteja el instrumento de impactos y caídas!
- Evite someter el instrumento a una temperatura ambiente superior a 60 °C. ¡El instrumento NUNCA debe ser hervido!
- Use solo los desinfectantes comerciales enumerados en la sección «Limpieza y desinfección» para limpiar el dispositivo y evitar daños en el dispositivo.
- Recomendamos que la precisión de este dispositivo se pruebe cada dos años o después de un impacto mecánico (por ejemplo, si se cae). Póngase en contacto con su servicio local Microlife para organizar la prueba.

ADVERTENCIA: El resultado de medición dado por este dispositivo no es un diagnóstico! No confíe sólo en el resultado de la medición.

Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desechar junto con la basura doméstica.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Pieza aplicada tipo BF

Puesta en marcha del termómetro

Para encender el termómetro, pulse el botón ON/OFF (1); un breve pitido o señal de bip indica que el «termómetro está encendido». Se realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en la pantalla.

Si la temperatura ambiente es inferior a 32 °C, una «L» fija y un «C» parpadeante aparecen en la pantalla (2). Ahora, el termómetro está preparado para realizar la medición de la temperatura.

Prueba de funcionamiento

El funcionamiento correcto del termómetro se comprueba automáticamente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de funcionamiento (medición imprecisa), se indica mediante «ERR» en la pantalla y ya no se puede realizar ninguna medición. En este caso, el termómetro debe sustituirse.

Uso del termómetro

Elija el método de medición preferido. Al tomar una medición, la temperatura actual se visualiza continuamente y el símbolo «C» parpadea. Cuando el pitido o señal de bip se escucha 10 veces y el «C» ya no parpadea, significa que el incremento medido de la temperatura es inferior a 0,1 °C en 16 segundos y ya se puede leer la temperatura.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón ON/OFF (1). En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos.

Memoria del valor medido

Oprima el botón de ON/OFF (1) durante 2 segundos al encender el termómetro para visualizar la última temperatura registrada en la memoria. Al mismo tiempo, en la pantalla aparece una «M» por memoria. Unos 2 segundos después de soltar el botón, el valor de temperatura desaparece y el termómetro está listo para tomar una medición.

Tipos de medición / Temperatura corporal normal

- En la axila (vía axilar) / 34,7 - 37,3 °C
Limpie la axila con una toalla seca. Coloque el sensor de medición (4) debajo del brazo en el centro de la axila para que la punta toque la piel y coloque el brazo del paciente al lado del cuerpo del paciente. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axilar toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable espere al menos 5 minutos, independientemente del pitido.

En la boca (vía oral) / 35,5 - 37,5 °C

No coma ni beba nada caliente o frío 10 minutos antes de la medición. La boca debe permanecer cerrada hasta 2 minutos antes de comenzar una lectura.

Coloque el termómetro en una de las dos bolsas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medición tiene que estar en buen contacto con el tejido (4). Cierre la boca y respire tranquilamente por la nariz para evitar que la medición sea influenciada por el aire inhalado/exhalado.

Si esto no es posible debido a vías aéreas bloqueadas, se debe utilizar otro método para medir.

Duración aprox. de la medición: 1 minuto!

► En el ano (vía rectal) / 36,6 - 38,0 °C

Atención: para la prevención de perforación rectal en niños (menores de 3 años), recomendamos utilizar otro método de medición (4) del termómetro.

Considera faptul că anumite moduri de măsurare pot necesita continuarea măsurării și după auzirea semnalului sonor, vezi capitolul «Metode de măsurare / Temperatura normală a corpului».

• Pentru siguranță (risc de perforație rectală), măsurarea rectală a temperaturii la copii sub 3 ani trebuie realizată doar de personal medical avizat (uz profesional). Se recomandă utilizarea altiei metode de măsurare. Pentru măsurarea rectală a temperaturii la copii sub 3 ani, utilizați termometru cu cap flexibil.

• Nu utilizați măsurarea rectală a temperaturii la pacientii cu patologie rectală. Folosind această cale de măsurare se agrava patologia existentă.

• Aveti grijă să nu lăsați instrumentul nesupraveghet la îndemnarea copiilor unele părți componente sunt suficiente de mici pentru a putea fi înghițiti. Aveți grijă, deoarece există risc de strugărire în cazul în care acest instrument este lăsat cu caburi sau tuburi.

• Se recomienda el uso de una cubierta de sonda y el uso de un lubricante.

• Si no está seguro de este método de medición, debe consultar a un profesional para obtener orientación / capacitación.

Duración aprox. de la medición: 1 minuto!

Limpieza y desinfección

Para la desinfección en el entorno de uso doméstico, use un hisopo con alcohol isopropílico al 70% o un pañojo de algodón humedecido con alcohol isopropílico al 70% para limpiar los contaminantes de la superficie de la sonda del termómetro. Siempre comience a limpiar desde el extremo de la sonda del termómetro (aprox. En el medio del termómetro) hacia la punta del termómetro. Luego todo el termómetro (véase el número (5) en el dibujo) debe sumergirse en alcohol isopropílico al 70% durante al menos 5 minutos (máx. 24 horas).

Después de la inmersión, deje que el desinfectante se seque durante 1 minuto antes del próximo uso.

Para uso profesional: Además, puede aplicar cubiertas de sonda (disponibles como accesorio). Comuníquese con Microlife para obtener más detalles sobre otros desinfectantes para su modelo de termómetro.

Sustitución de la batería

Cuando el símbolo ▶ (triángulo con la punta hacia abajo) aparece en la pantalla, la pila está baja y necesita cambiarse. Para cambiar la pila, levante la tapa (3) del compartimento de la pila del termómetro. Inserte la nueva pila que el signo + quede mirando hacia arriba. Procure tener a mano una pila del mismo tipo. Las pilas se pueden comprar en cualquier tienda de electricidad.

Especificaciones técnicas

Tipo: Termómetro de máxima

Nivel de medición: 32,0 °C a 43,9 °C

Temp. < 32,0 °C aparece «L» por low (demasiado baja)

Temp. > 43,9 °C aparece «H» por high (demasiado alta)

Condiciones de funcionamiento: ± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C

± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C y 42,1 - 43,9 °C

Condiciones de almacenamiento: 10 - 40 °C; 15 - 95 % de humedad relativa como máximo

25 - +60 °C; 15 - 95 % de humedad relativa como máximo

Batería: LR41 (1,5V) / SR41 (1,55V)

Duración de la batería: aprox. 4500 mediciones (usando una batería nueva)

Clase IP: IP67

Referencia a los estándares: EN 12470-3, termómetros clínicos; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Vida útil esperada: 5 años o 10000 mediciones

Este dispositivo está en conformidad con los requerimientos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Garantía

Este dispositivo está cubierto por una garantía de por vida a partir de la fecha de compra. Durante este periodo de garantía, a nuestra discreción, Microlife reparará o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita.

La garantía no será válida si abre o manipula el dispositivo.

Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:

• Costos de transporte y riesgos del transporte.

• Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.

• Daño causado por fugas de baterías.

• Material de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.

• Comprobaciones periódicas y mantenimiento (calibración).

• Accesorios y piezas de desgaste: Batería.

En caso de que se requiera un servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto o con su servicio local de Microlife. Puede ponerse en contacto con su servicio local Microlife a través de nuestro sitio web: www.microlife.com/support.

La compensación se limita al valor del producto. La garantía se otorgará si el producto completo se devuelve con la factura original. La reparación o el reemplazo dentro de la garantía no prolonga ni renueva el período de garantía. Los reclamos y derechos legales de los consumidores no están limitados por esta garantía.

Tipos de medición / Temperatura corporal normal

En la axila (vía axilar) / 34,7 - 37,3 °C
Limpie la axila con una toalla seca. Coloque el sensor de medición (4) debajo del brazo en el centro de la axila para que la punta toque la piel y coloque el brazo del paciente al lado del cuerpo del paciente. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axilar toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable espere al menos 5 minutos, independientemente del pitido.

En la boca (vía oral) / 35,5 - 37,5 °C

Limpie la axila con una toalla seca. Coloque el sensor de medición (4) debajo del brazo en el centro de la axila para que la punta toque la piel y coloque el brazo del paciente al lado del cuerpo del paciente. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axilar toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable espere al menos 5 minutos, independientemente del pitido.

En la boca (vía oral) / 35,5 - 37,5 °C

Descrierea acestui termometru

1. Butonul pornit/oprit
2. Afisaj
3. Capacul compartimentului pentru baterie
4. Senzor pentru măsurare/sondă pentru măsurare
5. Suprafata pentru dezinfecție și curățare/intraşa suprafață a termometrului

Instrucțiuni de siguranță importante

- Urmăriți instrucțiunile de utilizare. Acest document oferă informații importante privind funcționarea și siguranța dispozitivului. Citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l pentru a fi utilizat în viitor.
- Acest aparat este destinat pentru măsurarea temperaturii corpului uman - oral, rectal sau axilar. Nu încercați să măsurăți temperatură în alte moduri, cum ar fi auricular, pentru că aparatul poate fi deteriorat sau va avea rezultate false.

- Acest aparat este destinat pentru măsurarea temperaturii corpului uman - oral, rectal sau axilar. Nu încercați să măsurăți temperatură în alte moduri, cum ar fi auricular, pentru că aparatul poate fi deteriorat sau va avea rezultate false.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, introduceți-l în aparatul de măsurare.